

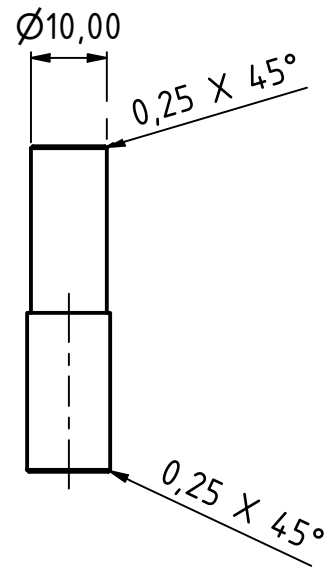
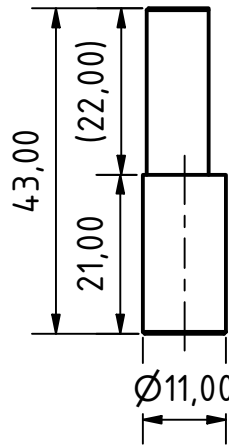
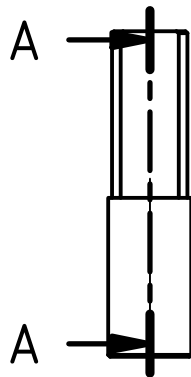


A-A ( 1 : 1 )

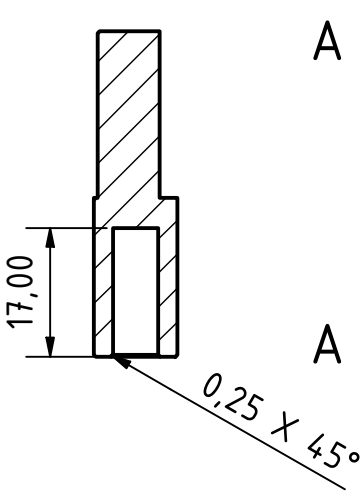

Tolerierung ISO 8015 DIN ISO 2768 mK				Werkstoff: Edelstahl		
				Spetec Ventilation Arm		
		Datum	Name			
		Gezeichnet	09.02.2023			ge43sir
		Kontroll				
		Norm				
		Lehrstuhl für Biomedizinische Elektronik (LBE)		Spetec_Ventilation_Arm	1	
Status	Änderungen	Datum	Name		A4	
				Maßstab 1 : 1		